HUMAN CARE
Your Life. Your Way.

Staffan RA

Denna rekonditioneringsanvisning gäller för rollatorn och dess tillgängliga tillbehör och reservdelar.

⚠ För att hjälpmedlet skall fungera tryggt och säkert för brukaren bör översyn av hjälpmedlet göras en gång per år. Därför rekommenderas följande åtgärder.

☐ **Rengöring & Desinfektion**
Vid rengöring rekommenderas vatten och milt rengöringsmedel. Maskintvätt 60°C i 10 min kan användas, torkning max 70°C i 10 min, observera efterbehandlingskraven. Undvik att spola med tryck mot lager (hjul, framgafflar). **OBS!** Använd INTE lacknafta, bensin eller andra lösningsmedel.
Desinfektion utförs av behörig personal med lämplig skyddsutrustning och enligt desinfektionsmedelstillverkarens instruktioner. Vid rengöring använd en svamp eller mjuk trasa som inte repar produkten. Använd ett godkänt kemiskt desinfektionsmedel som innehåller 70-80% etanol. Använd ej rengöringsmedel med slipmedel, klor eller fenom. Vid frågor om desinfektion eller lämpliga desinfektionsmedel kontakta Human Care.

☐ **Efterbehandling**
Efter tvätt skall alla leder, trånga utrymmen samt dräneringshålen blåsas torra och sprejas med tunnflytande olja. Om avfettningsmedel använts bör de rörliga delarna smörjas.

☐ **Lacken**
Kontrollera skador i lacken. För att förhindra korrosionsskador, bättra på repor. Bättringsfärg kan beställas från Human Care HC AB.

☐ **Rörstomme**
Svets och skruvförband kontrolleras. Vid större korrosion ska rollatorn bytas.



☐ **Handtag**
Ska sitta fast. Kontrollera att handtagsrören går att skjuta ner i chassit. Byt greppet vid behov.

☐ **Bromsar**
Kontrollera att både färd- och parkeringsbroms fungerar. Wirar ska vara hela och uppklamrade.

☐ **Vingvred**
Kontrollera funktionen.

☐ **CE-märkning**
Kontrollera att CE-märkningen finns kvar och att den går att läsa.

☐ **Hjul**
Kontrollera att hjulen inte är slitna och att de snurrar lätt utan oljud.

☐ **Smörjning**
Framgafflarna ska fungera utan oljud, smörj vid behov.



☐ **Framgafflar**
Kontrollera att de snurrar lätt.

☐ **Stabilitet**
Kontrollera att alla hjul står stadigt på underlaget och att det inte finns någon skevhet i chassit.

☐ **Provkörning**
Gör en slutlig kontroll genom en provkörning.

Human Care HC AB
Stambanegatan 17
117 60 Stockholm

08 510 132 00
www.humancaregroup.com

HUMAN CARE
Your Life. Your Way.

REKONDITIONERINGSANVISNING

Observera!
Rekonditioneringen skall endast ske av en person som har god kännedom om hur arbetet ska utföras. En felaktig utförd rekonditionering kan resultera i en olycka/tillbud. Vid oklarheter kontakta alltid återförsäljare.

Vid byte av delar på hjälpmedlet ska endast originaldelar användas för att CE-märkningen ska gälla.

Vid demontering av hjul måste hjulmutter och pinnbult bytas, då de innehåller en självlåsning som förstörs när de demonteras.

Om det har uppstått korrosion som är kraftigare än ytrost ska rollatorn tas ur bruk och lämnas för återvinning.

Avsedd användning
Rollatorn får endast användas som gångstöd. Egna ingrepp i hjälpmedlet är inte tillåtet.

Produktnummer:
Ägare:
Anmärkningar / Anteckningar:
Åtgärdad av:
Ort och datum:


Human Care HC AB
Stambanegatan 17
117 60 Stockholm

08 510 132 00
www.humancaregroup.com

HUMAN CARE
Your Life. Your Way.

Reservdelslista

Nr	Benämning	Antal	Art. nr	Övrig information
1	Knopp	2	20-014	
	Hjulkit	**4**	**89015**	*Pinnbult och hjulmutter måste bytas vid demontering av hjulet.*
2	Komplett hjul	4		
3	Hjulmutter	4		
4	Pinnbult	4		
	Vingvred komplett	**4**	**50937**	*Smörj vingvredet vid behov.*
5	Vingvred	4		
6	Skruv	4		
7	Bricka	4		
8	RA handtag	2	20-064	
9	Handbroms komplett	2	10650	*Komplett med hållare, bromshandtag och nit.*
10	Handtag	2	00020	
11	RA-dynan	2	20-054	
12	RA-armstöd höger	1	400-001H	*Staffan RA låg*
12	RA-armstöd höger	1	400-028H	*Staffan RA hög. Komplett med teleskoprör.*
13	RA-armstöd vänster	1	400-001V	*Staffan RA låg*
13	RA-armstöd vänster	1	400-028V	*Staffan RA hög. Komplett med teleskoprör.*
14	Teleskoprör	1	400-025	*Staffan RA låg*
	Hölje	2	00013	*Staffan RA låg*
	Hölje	2	00014	*Staffan RA hög*
	Vajer	2	00005	*Staffan RA låg*
	Vajer	2	00003	*Staffan RA hög*

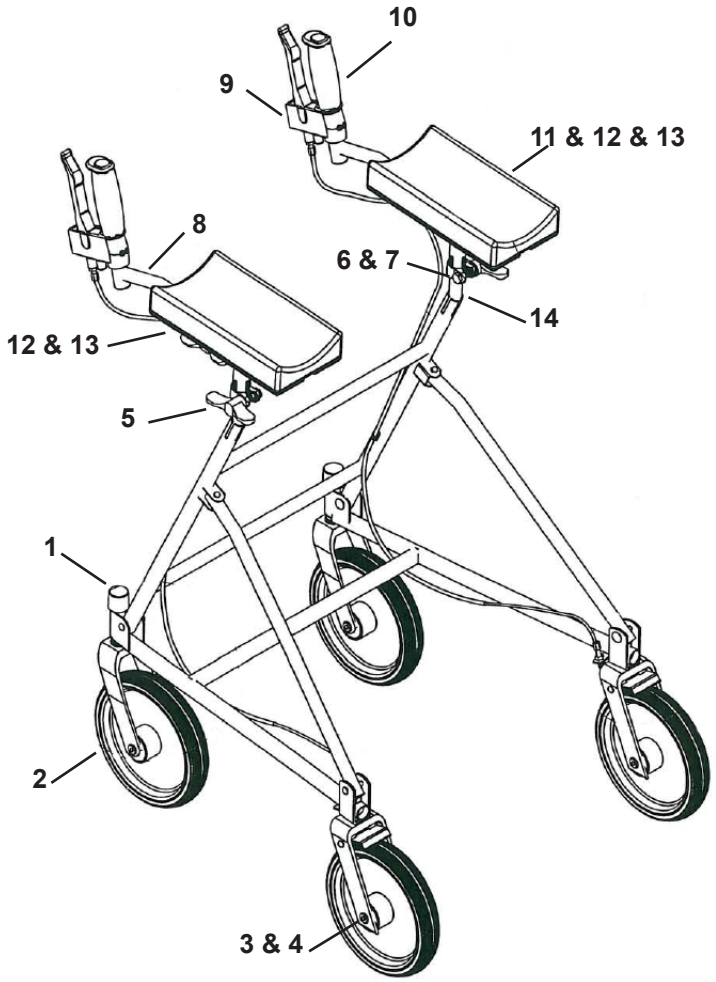

99217, Rev J, SE, Rekonditionering, Staffan RA, Oct26